

РейГард®

ЗДРАВЕ И В КОЛАТА С CAR CHIPS НА РЕЙГАРД


На 7 и 8 февруари 2018 г. бе проведено изследване по влиянието на електромагнитните полета на автомобила върху здравето на водача.

Първият ден изследването бе проведено с шофьора след изминаването на 30 км пробег, като на колата не бяха инсталирани защитни устройства.

Картината на кръвта на шофьора показва силен оксидативен стрес, мощна еритроцитна агрегация. Бе отчетено повишено напрежение и умора на водача.

Вторият ден беше изминат същият маршрут, но в колата бяха инсталирани защитни устройства - чипове за кола и на ключодържател по технологията **RayGuard®**.

Резултатите показаха значително по-добра картина и динамика на кръвта на изследвания. Оценката на шофьора е, че се е чувствал по-спокоен и е по-бодър при употребата на CAR CHIPS.

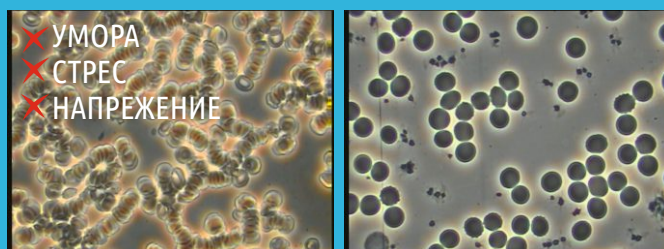

КРЪВТА НА ВОДАЧА
без CAR CHIPS

КРЪВТА НА ВОДАЧА
с CAR CHIPS

УМОРА
СТРЕС
НАПРЕЖЕНИЕ

РейГард®

ПРОДУКТИ И УСТРОЙСТВА



RayChip - защитен чип за мобилни телефони, телевизори, лаптопи, безжични устройства и превозни средства. Диаметър на действие - **1 метър**

RayChip - защитна висулка за тяло. Диаметър на действие - **1 метър**



RayGuard® Body & Car - защитен ключодържател за кола. Диаметър на действие - **2 метра**

RayGuard® Mobil - преносимо устройство за колата, дома и офиса. Диаметър на действие - **4 метра**



RayGuard® Swiss pine energy+ - Швейцарски бор енерджи плюс с ароматично и защитно действие. Диаметър на действие - **10 метра**

RayGuard® Home - дървен купол от орех или клен. Диаметър на действие - **14 метра**




RayGuard® Home - защитни конуси от композитен материал или от швейцарски бор. Диаметър на действие - **30 метра**



9000 Варна,
ул. Христо Самсаров 26
Т/Ф +359 52 65 75 75
М +359 899 171 090
office@bionositeli.com

РейГард®

ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА ОТ
ЕЛЕКТРОСМОГА И РАДИАЦИЯТА

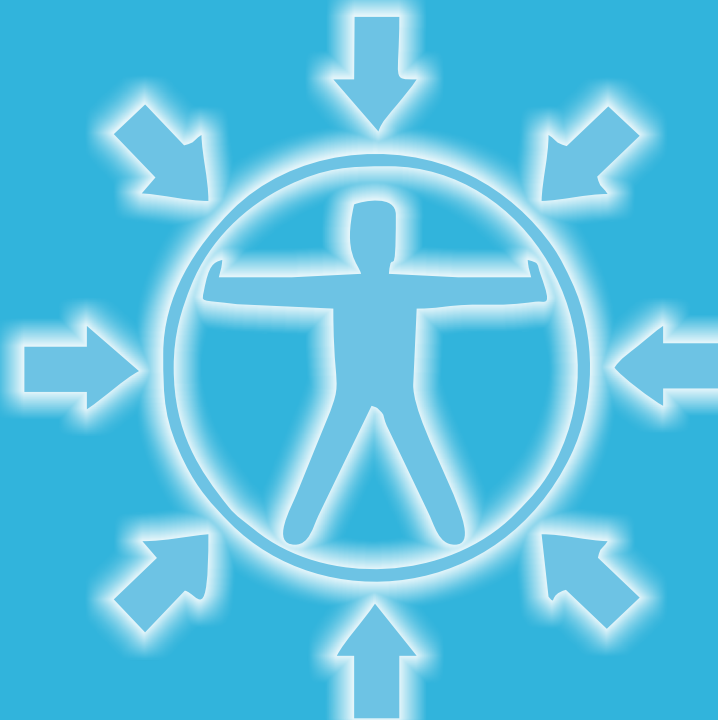

Решението за защита от електросмога и радиацията



RayGuard.info



RayGuard.info




RayGuard.info

Влиянието на електросмога


Човешкото тяло е подложено на електромагнитно облъчване. Управляващите команди от мозъка не се предават правилно и понякога дори се предават погрешни команди. Също така се стига до разстройство в клетъчния метаболизъм, довеждайки до органична недостатъчност и, като дългосрочен страничен ефект, тъканни изменения. **Човек се разболява.** Регулирането, което нормално действа автоматично, е сериозно нарушено от електромагнитните въздействия.

Биологични ефекти от електросмога:

- **Нарушения на съня**
- **Нарушения на концентрацията**
- **Нарушения на кръвообращението**
- **Главоболие**
- **Умора**
- **Шум в ушите**
- **Нервност**
- **Алергии**
- **Депресии**
- **Спадане на активността**

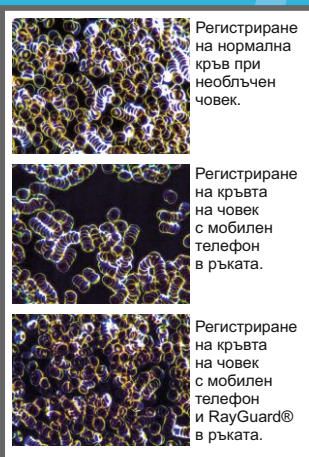

Фиг.3 Изследване на кръвта

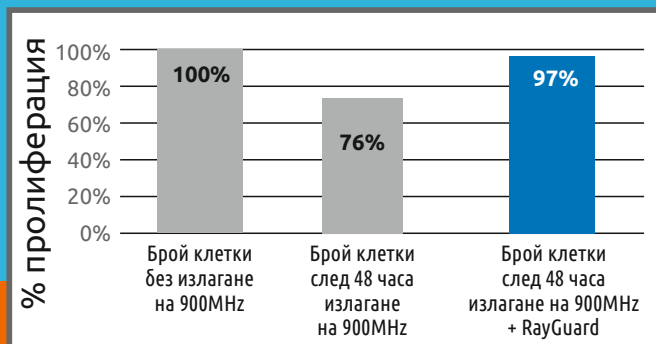

Фиг.1

Положителните изменения в кръвната картина от използването на RayGuard® могат да се видят с помощта на тъмно-полева микроскопия!

Експерименти с RayGuard®, потвърждаващи ефективността

Ефектът на RayGuard® е научно тестван от д-р Ф. Маринели (CNR - Болоня).

Резултатите:

1. Електромагнитното облъчване произведе явно намаляване на клетъчната пролиферация и изменение на клетъчния цикъл след 48-часово излагане на действието му. (Фиг.1)

2. RayGuard® недвусмислено защити клетките от намаляване на клетъчната пролиферация и изменения на клетъчния цикъл. (Фиг.2)

Това е първият път, когато един научен експеримент беше в състояние да покаже защитния ефект върху човешки клетки от едно електросмогово устройство. Резултатите са видими (Фиг.3) и статистически значими.



Фиг.2 Контрол на терапията – меридиани

РейГард в България


През януари 2018 година изследвахме влиянието на техногенното излъчване на компютър върху качествата на вода с добавено количество физиологичен разтвор - 0,25% енергитизирана под пирамида с пропорции на Хеопсовата пирамида в продължение на 1 час.

Защитните PHONE CHIPS на РейГард отчетливо и трайно защитават изложената на вредно влияние вода. Ползата от употребата им се разпростира от мобилни и преносими телефонни устройства до таблети, лаптопи, телевизори и стационарни компютри и се вижда по промяната на водата, анализирана под микроскоп по авторската методика на ИванТодоров - радиестезист и експерт по сложни системи.

РЕВИТАЛИЗИРАНА ВОДА - ЕНЕРГИЗИРАНА ПОД ХЕОПСОВА ПИРАМИДА



СЛЕД 30 мин. ПРЕД КОМПЮТЪР БЕЗ ЗАЩИТА

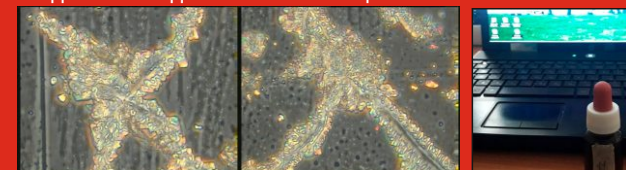

СЛЕД 30 мин. ПРЕД КОМПЮТЪР СЪС ЗАЩИТА ОТ RAYGUARD PHONE CHIPS



ВИДИМО ОТСЪВВИЕ НА ВРЕДНОТО ВЛИЯНИЕ